Zusätzliche Aufbereitungsanleitung

Handbohrapparate BUNELL / RALK

REF 40-918-00 / 40-919-00 / 40-919-01

AS Medizintechnik GmbH
Sattlerstraße 15
78532 Tuttlingen / Germany
Phone:+49 7461 9663026
info@AS-Medizintechnik.de
DE

1. Allgemeine Grundlagen

Die zusätzliche Aufbereitungsanleitung für Handbohrapparate dient als Ergänzung zu der bestehenden Gebrauchsanweisung GU_300_DE Chirurgische Instrumente sowie zu der Masteraufbereitungsanleitung AU_100_DE_Masteraufbereitungsanleitung Geometrische Aspekte Worst Case Code „D".

2. Anwendung / Produkte

Handbohrapparate für die Verwendung von Bohrern bis max. Ø 4,0 mm und Bohrdrähten aus Stahl oder Titanium bis max. Ø 4,0 mm:

40-918-00	Bunnell Handbohrapparat mit Jacobs Bohrfutter, Spannweite 0 - 4 mm, Durchgangsbohrung Ø 4 mm, mit Spannschlüssel
40-919-00	Ralk Handbohrapparat, mit Jacobs Bohrfutter, Spannweite 0 - 4 mm, Durchgangsbohrung Ø 5 mm, mit Spannschlüssel
40-919-01	Ralk Handbohrapparat lang mit Jacobs Bohrfutter, Spannweite 0 - 4 mm, Durchgangsbohrung Ø 5 mm, mit Spannschlüssel

BUNNELL

40-918-00

Handbohrapparat und Spannschlüssel 40-816-99
Hand drill and key 40-816-99
Perforador de mano con llave 40-816-99
Trapano a mano per ossa e chiave 40-816-99

RALK

40-919-00

Handbohrapparat und Spannschlüssel 40-816-99
Hand drill and key 40-816-99
Perforador de mano con llave 40-816-99
Trapano a mano per ossa e chiave 40-816-99

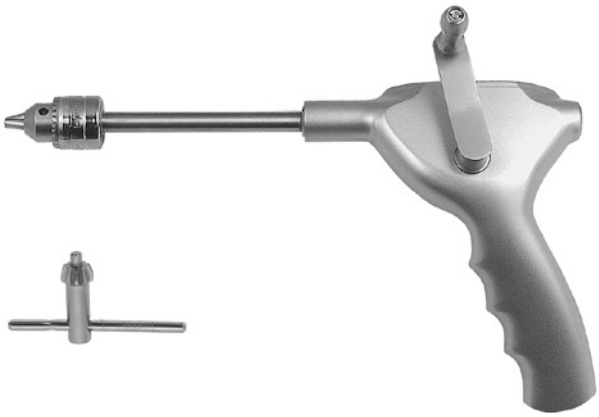

RALK

40-919-01

Handbohrapparat und Spannschlüssel 40-816-99
Hand drill and key 40-816-99
Perforador de mano con llave 40-816-99
Trapano a mano per ossa e chiave 40-816-99

REF 40-918-00 / 40-919-00 / 40-919-01

AS Medizintechnik GmbH
Sattlerstraße 15
78532 Tuttlingen / Germany
Phone:+49 7461 9663026
info@AS-Medizintechnik.de

DE

2. Aufbereitung

Zusätzlich zu den Angaben in der Masteraufbereitungsanleitung ist folgendes zu beachten:

Das JACOBS Bohrfutter bedarf einer zusätzlichen manuellen Vorreinigung.

ACHTUNG:
Das Gehäuse bei den Artikeln 40-919-00 und 40-919-01 beinhaltet ein geschlossenes Schneckengetriebe und einen größeren Hohlraum und sollte deshalb möglichst nicht im Ultraschallbecken getaucht werden.

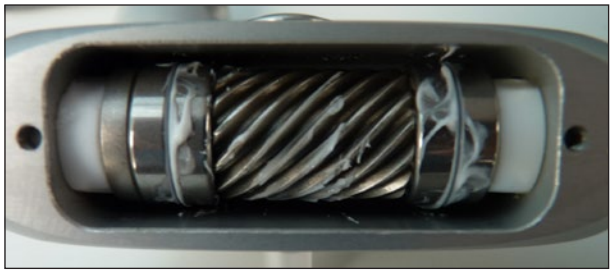

Manuelle zusätzliche Vorreinigung:

1. Bohrfutter komplett öffnen

2. Mitgelieferte Reinigungsbürste Ø 5 mm lateral einführen

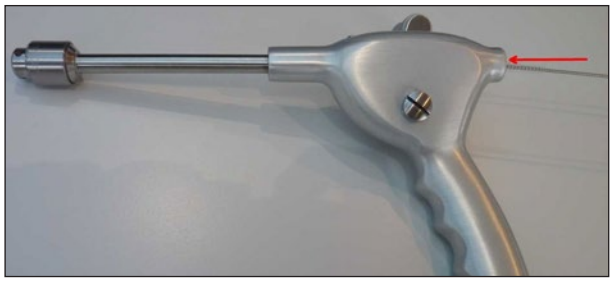

3. Reinigungsbürste mehrmals durch das Lumen schieben bzw. ziehen.

4. Das Lumen mit der Wasserpistole durchspülen und dabei das Bohrfutter schließen und öffnen.

5. Anschließend den Handbohrapparat gem. Masteraufbereitungsanleitung in den maschinellen Reinigungsprozess geben.

DIE AS MEDIZINTECHNIK GMBH ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG, WENN NACHWEISLICH GEGEN DIESE KUNDENINFORMATION VERSTOSSEN WURDE.